

6.4. На гидроблок со слюноотсосом, ремонт которых проводится специалистами, не имеющими допуска от изготовителя, гарантии изготовителя не распространяются.

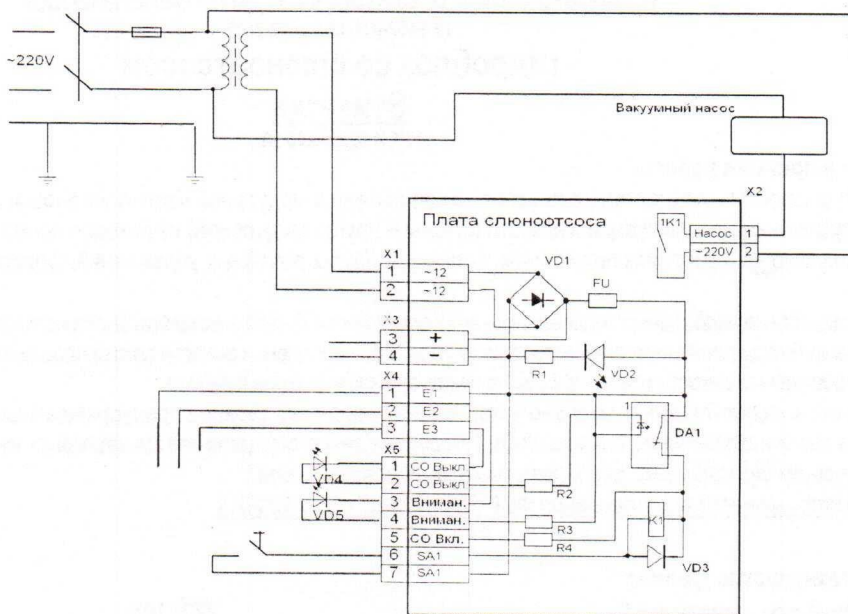


Схема электрическая принципиальная

7. Сведения о рекламациях

7.1. В случае отказа или неисправности гидроблока со слюноотсосом в период действия гарантийных обязательств, владелец должен

направить в адрес организации, осуществляющей ремонт или завода-изготовителя следующие документы:

- заявку на ремонт с указанием своего адреса и контактного телефона;
- утвержденный акт о замеченных неисправностях.

7.2. При отправке в ремонт производителю поставщик или заказчик должны предварительно согласовать условия и сроки отправки гидроблока. При отправке на завод-изготовитель гидроблок должен быть упакован в соответствии с п.4.1 настоящего документа.

8. Свидетельство о приемке, поставке и продаже гидроблока со слюноотсосом

8.1. Свидетельство о приемке

Гидроблок со слюноотсосом 462
(заводской номер)

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан пригодным для эксплуатации



Представитель ОТК

Нобелько В. В.
расшифровка подписи

16.03.2016
число, месяц, год

8.2. Свидетельство о поставке

Поставщик

_____ наименование

_____ обозначение документа по которому производится поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

8.3. Свидетельство о продаже

Продавец

_____ наименование

_____ обозначение документа по которому производится продажа

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год