ОКП 94 5210

РУ № ФСР 2010/07065 от 03.11.2015 г. ДС РОСС RU.МН08.Д01688

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ КГ-1
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
Ц5040.00.000 ПС

Уважаемый Покупатель!
Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед регулировкой и эксплуатацией.
Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 (в дальнейшем - кресло) предназначено для помещения на него женщин при гинекологических обследованиях, проведении различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах.
Кресло применяется в медицинских учреждениях.
Кресло изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 и 04.2 по ГОСТ Р 50444 в соответствии с требованиями ТУ 9452-021-07614107-2004.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Длина (от подножки до спинки в разложенном виде)	1605 ± 50 мм
Ширина (по подколенникам)	925^{+50}_{-20} мм
Высота кресла	1640 ± 50 мм
Высота кресла в разложенном виде	900 ± 30 мм
Масса	45 кг
Предельная рабочая нагрузка на кресла	180 кг
Углы наклона: - спинки от вертикали - сиденья от горизонтали (с предельным отклонением ± 5°)	 20° - 100° 0° - 20°
Усилие, необходимое для перемещения тазика, не более	5 кг
Усилия, прилагаемые к рукояткам зажимов для фиксации съёмных частей и к зажимному винту стойки, не более	10 кг
Усилие, необходимое для расфиксации спинки п переводе из одного положения в другое, не более	12 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием и улучшением данного изделия.

3. Комплектность

Таблица 2

№ п\п	Наименование	Величина номинальной нагрузки, не более	Количество, штук
1	Кресло гинекологическое с ручным приводом (без съёмных частей)	60 кг - на спинку 120 кг - на сиденье 120 кг - на подножку	1
Съёмные части			
2	Подколенник	20 кг на каждый	2
3	Тазик или тазик со сливом	4 кг	1
4	Упор для рук правый	20 кг	1
5	Упор для рук левый	20 кг	1
Эксплуатационная документация			
6	Руководство по эксплуатации (паспорт)		1

3.1. Дополнительные съёмные части могут быть поставлены Заказчику по отдельному договору с заводом-изготовителем.
3.2. Перечь дополнительных съемных частей приведен в таблице 3.

Таблица 3

№ п\п	Наименование	Количество, штук
1	Подголовник	
2	Столик инструментальный	1
3	Штатив для вливаний	1

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер безопасности

4.1. Основание 15 кресла снабжено двумя роликами 1 для передвижения, шарнирной подножкой 2, спинкой 7 и сиденьем 8 с механизмами наклонов и подушками 6, съёмными частями.
4.2. После получения кресла, распакуйте его, установите съёмные части согласно рисунка 1 в необходимое положение и закрепите их винтами, зажимами 18 (СМ. пункт 4.5.).
4.3. Для регулировки наклона сиденья вывести тазик или тазик со сливом из зоны сиденья, поднять собачку 11 вверх, поверните в сторону буквы “П” (подъём) или “О” (опускание) движением рукоятки 16 влево - вправо, регулируйте наклон, при этом регулировку производите сбоку сиденья при поднятых вверх стержней подколенника 3.
4.4. Для регулировки наклона спинки 7 поднимите рукоятку 9 вверх, установленную на коробке 13, отрегулируйте наклон, затем зафиксируйте его нажатием рукоятки 9 вниз.
Во время регулировки наклона спинки 7 удерживайте спинку рукой от падения.
4.5. Под сиденьем в кассете 20 разместите выдвижной тазик или тазик со сливом 19 для сбора жидкости. Кассету 20, при поставке не в сборе с креслом, установите согласно рисунка 1, закрепив ограничительные шайбы винтами на торцах направляющих после установки во втулках под сиденьем кресла.
4.6. Подножку 2 установите в необходимое положение.
4.7. Перед использованием съёмных частей 3 и 5 убедитесь в надёжности их фиксации зажимами 18. При установке упоров для рук (правого и левого) 4 и 5 обратите внимание, чтобы лыска была расположена к зажимному винту.
4.8. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**: регулировка частей с пациентом, размещенным на кресле, а также эксплуатация неисправного кресла.
Перед каждым использованием убедитесь в надёжности фиксирования закрепления всех частей кресла.

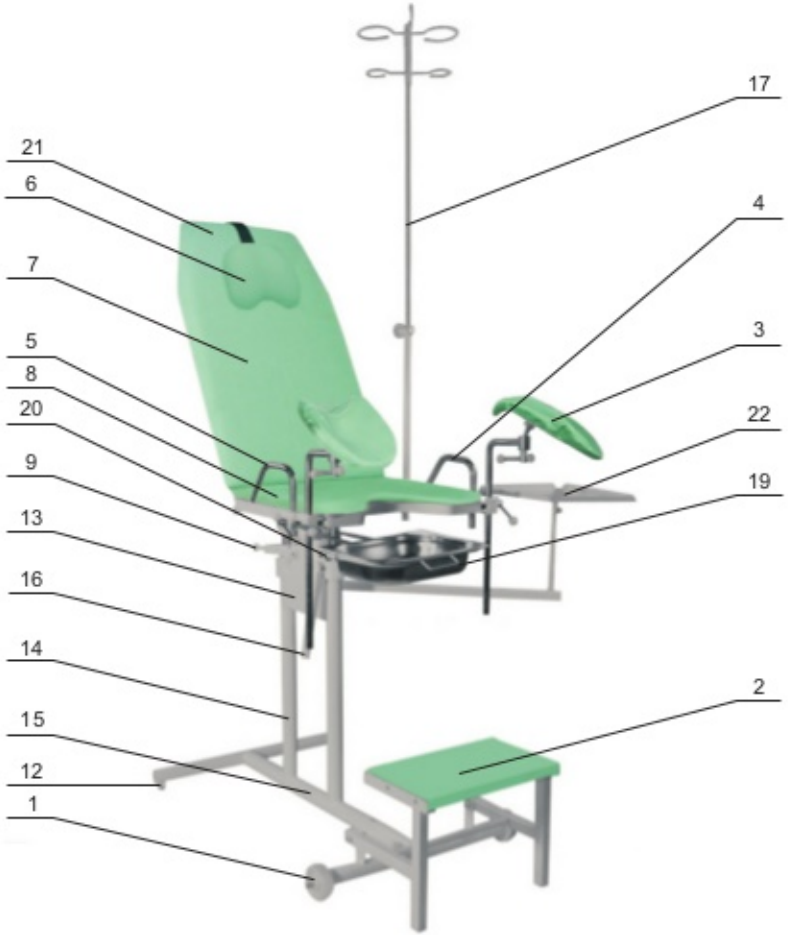

1 - ролик; 2 - лабиринная подножка; 3 - подколенник; 4 - упор для рук (левый); 5 - упор для рук (правый); 6 - подушка; 7 - спинка; 8 - сиденье; 9 - рукоятка; 10 - винт; 11 - собачка; 12 - регулируемая опора; 13 - коробка; 14 - стойка; 15 - основание; 16 - рукоятка; 17 - штатив для вливаний; 18 - винт зажим; 19 - таз или таз со сливом; 20 - кассета; 21 - подголовник; 22 - столик инструментальный.

Рисунок 1

5. Техническое обслуживание

5.1. Перед вводом в эксплуатацию и перед эксплуатацией необходимо расконсервируйте кресло промывкой моющими растворами, проверьте отсутствие погнутых деталей, вмятин, коррозии металла, крепление всех болтовых и других видов соединений всех частей кресла, убедитесь в надёжности фиксирования и крепления, при необходимости закрепите их, произведите санитарную обработку перед использованием и после каждого использования.
5.2. Проверку технического состояния, с целью установления возможности дальнейшего использования, проводите: проверкой углов наклона по пункту 1.5. спинки и сиденья с помощью любых доступных угломеров или средств; проверкой усилий по пунктам 1.6., 1.7., 1.8. с помощью динамометров ДПУ-0,2-2-УХЛ по ГОСТ 13837; проверкой работы механизма фиксации спинки размещением на ней равномерно-распределенной нагрузки 90 кг, после

выдержки в течение 2 часов спинка не должна смещаться вниз под нагрузкой; проверкой комплектности по пункту 3 и других параметров.
5.3. Характерные неисправности кресла: ослабление крепёжных резьбовых и других элементов устранить подтягиванием или заменой на годные элементы; затруднение наклона сиденья устранить разборкой, при необходимости, заменой изношенных деталей на годные, последующей смазкой трущихся поверхностей консистентной смазкой и сборкой стакана с собачкой 11 и винтом 10, установленных в стойке 14.
5.4. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлоромина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

6. Консервация

6.1. Металлические детали кресла и съёмных частей должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2"С" со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).
6.2. Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-1 подвергнуто в АО "ДЗМО" консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-021-07614107-200.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование кресла должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.
7.2. Кресло должно храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги.
Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.
7.3. Для перемещений кресла внутри помещений используются встроенные колесные опоры приподнимите кресло за раму основания (наклоните в сторону сиденья) до отрыва от пола задних опор и переместите кресло в нужное место.
При необходимости, отрегулируйте опоры.
7.4. Для перемещения кресла по порогам, лестницам и в другое помещение - обязательно полностью поднимайте кресло за раму основания, предназначенными для этого средствами достаточной грузоподъёмностью.

Запрещается подъём, наклон или переноска кресла за спинку и съёмные приспособления - это может привести к механическим повреждениям и потере гарантии производителя. Также, запрещается вставать (садиться) на спинку кресла.

8. Сведения об утилизации

Поскольку кресло не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
9.2. Гарантийный срок 24 месяца при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-021-07614107-2004.
9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.